

Infiltrations échoguidées en première ligne matériel suggéré

Livres de référence

Atlas of Ultrasound-Guided Musculoskeletal injections
Gerard Malanga – Kenneth Mautner
ISBN-13: 978-0071769679
ISBN-10: 0071769676

Désinfection

- Solution chlorhexidine 2% + alcool 70% (avec compresses stériles)
ou
- Applicateurs chlorhexidine 2% + alcool 70%

Préparation

- Tampons d'alcool (pour désinfecter les fioles de médicaments)
- Seringues 3 ml avec aiguilles 22 G- 1 po (pour prélever les médicaments)

- Depo-Medrol 40mg /ml
- ± Kenalog 40 mg/ml (seulement en intra-articulaire)
- Chlorhydrate de lidocaïne à 2 % - 20 mg/mL (pour infiltrations diagnostiques)
- Chlorure de sodium à 0,9 % injectable bactériostatique

- Gants stériles
- Couvre-sondes stériles (le gel stérile ainsi que 2 élastiques sont habituellement inclus dans chaque paquet individuel – valider avec le fournisseur)
- Masques

Pour ponctions

- Aiguilles 18G-1½ po ou 20G-1½po
- Seringues 20 ml (épanchements modérés)
- Seringues 60 ml (gros épanchements)

Pour infiltrations

- Aiguilles 27G-1½ po ou 25-1½ po
- Aiguilles 22G-4po ou 22G-2¾po (pour infiltrations profondes)
- ± Rallonges pour dispositif IV avec adaptateur Luer mâle

Pour ponctions-infiltrations

- Raccords à 3 voies avec robinet

Pour réaction anaphylactique

- Épinéphrine 1:1000 - 1 mg/ml en ampoule
- Posologie : 0.3-0.5 ml IM dans la cuisse

- Diachylons

Quelques fournisseurs

- Maranda Lauzon : <https://www.marandalauzon.com/fr/>
- Dufort Lavigne : <https://www.dufortlavigne.com/>
- Polimed : <https://polymed.ca/>


Couvre-sondes :

- <https://www.marandalauzon.com/fr/echographie-electrophysiologie/protecteurs-pour-sondes.html>
- Dufort et Lavigne : couvre-sonde 7 x48 po avec 2 élastiques (PAMPCO2352R3)


2 options selon le besoin :



Exemple d'aiguilles 22G x 4 po utilisées durant les formations (Dufort et Lavigne, code : JGM8300059226) :

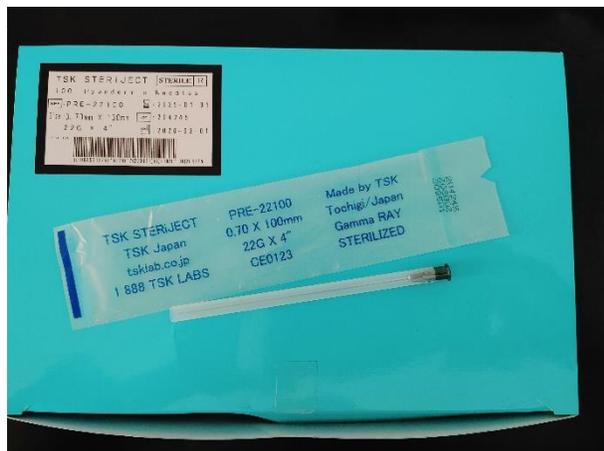

Exemple d'aiguilles 22G x 1 ½ po utilisées durant les formations (Dufort et Lavigne, code : BEC305156) :

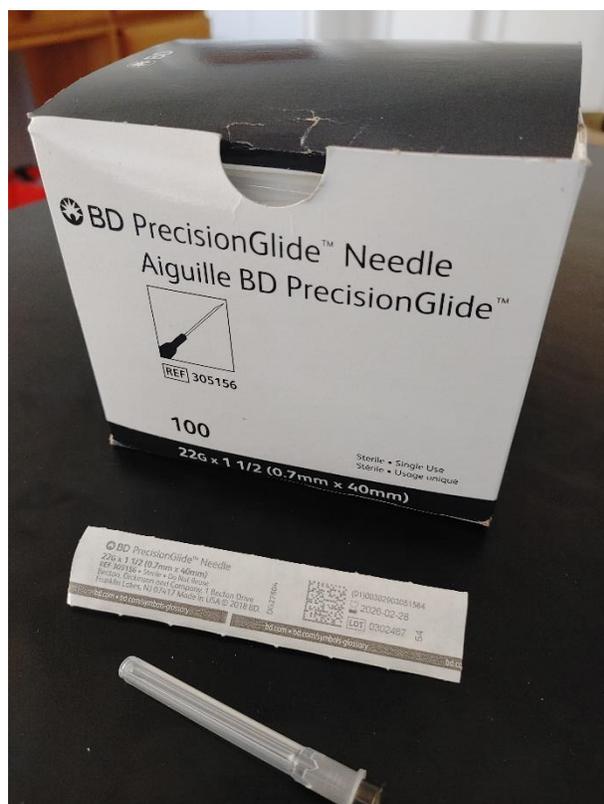

N.B : Les codes d'article donnés en exemple pourraient changer. Valider auprès du fournisseur au besoin.